




CE2265

MARTIKAN s.r.o.
018 02 Dolná Mariková 789
Slovenská Republika

DENTÁLNE IMPLANTÁTY

MV 3,0

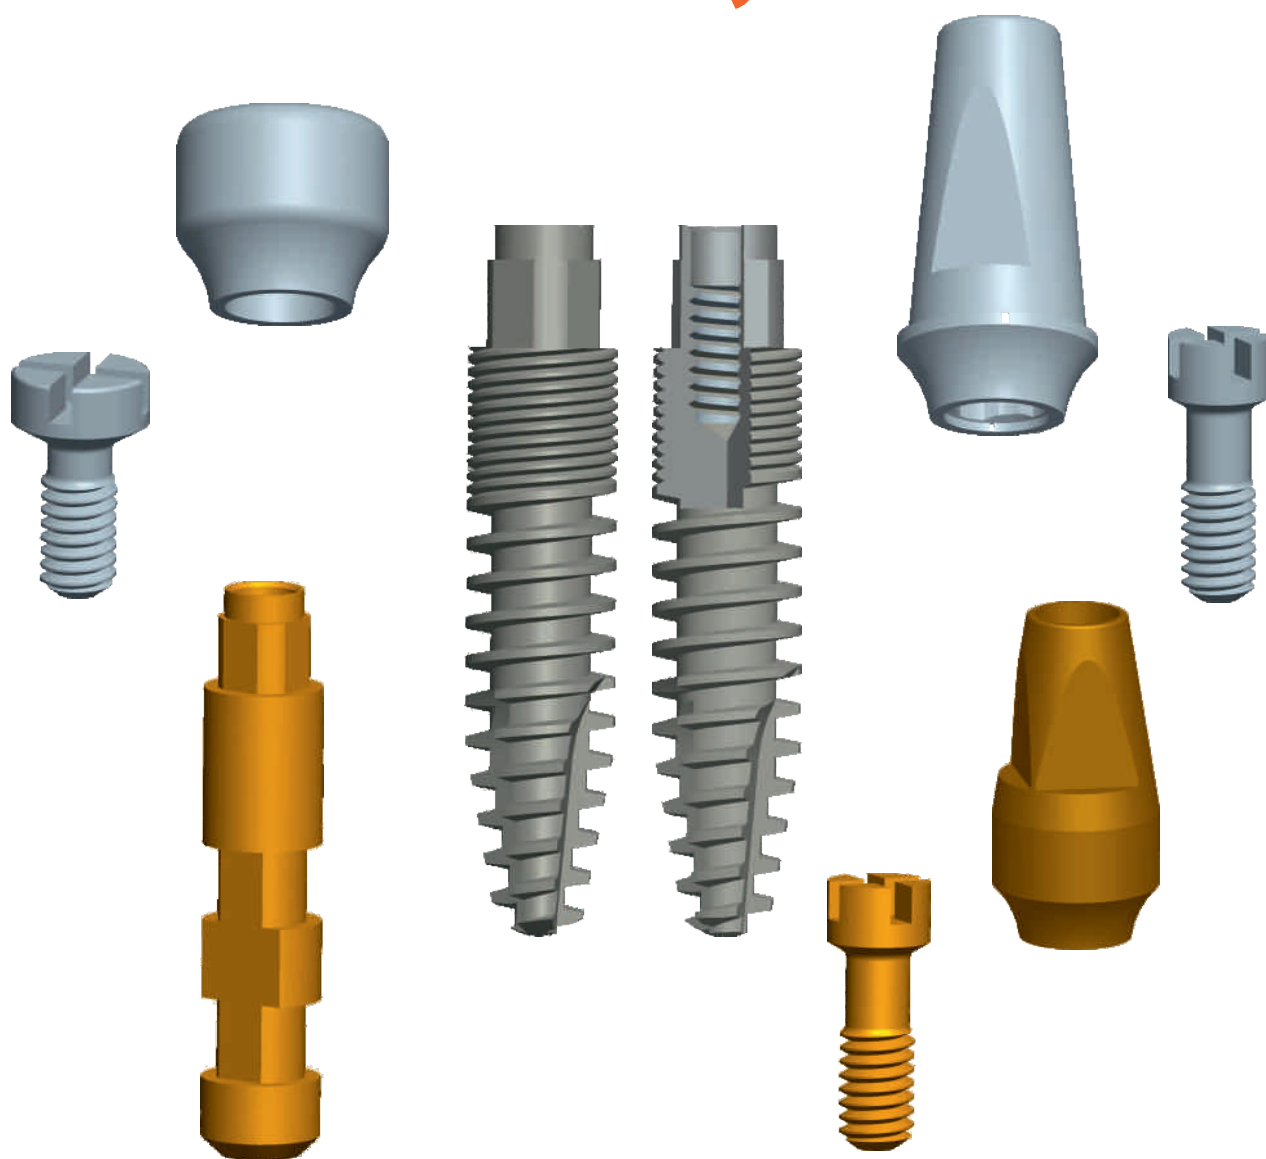


DENTÁLNE IMPLANTÁTY MV 3,0

Dentálny implantát	Vhojovací valček	Vhojovací valček - úzky	Vhojovacia skrutka	Pilier	Pilier-úzky	Skrutka	Laboratórny implantát	Laboratórna skrutka	Odtlačovací valček	Odtlačovacia skrutka
<p>MV 3,0 - L</p> <p>D = 3,0 mm</p> <p>MV 3,0 - 10 MV 3,0 - 12 MV 3,0 - 14 MV 3,0 - 16</p>	<p>Označenie: MVV 3,0 - L</p> <p>MVV 3,0 - 4 MVV 3,0 - 5 MVV 3,0 - 6</p>	<p>Označenie: MVVU 3,0 - L</p> <p>MVVU 3,0 - 4 MVVU 3,0 - 5 MVVU 3,0 - 6</p>	<p>Označenie: MVS 3,0</p>	<p>Označenie: MP 3,0 - L</p> <p>MP 3,0 - 2 MP 3,0 - 3 MP 3,0 - 4</p>	<p>Označenie: MPU 3,0 - L</p> <p>MPU 3,0 - 2 MPU 3,0 - 3 MPU 3,0 - 4</p>	<p>Označenie: MS 3,0</p>	<p>Označenie: MLI 3,0</p>	<p>Označenie: MLS 3,0</p>	<p>Označenie: MOV 3,0</p>	<p>Označenie: MOS 3,0</p>

Nástroje pre dentálne implantáty MV 3,0

<p>Trojhranný vrták</p> <p>Označenie: 3HR d</p> <p>3HR 2,0</p>	<p>Pilotný vrták</p> <p>Označenie: MV D - d</p> <p>MV 3,0 - 2,0 N 315</p>	<p>Zahlbovací vrták</p> <p>Označenie: VM D</p> <p>VM 3,0 N 312</p>	<p>Mierka</p> <p>Označenie: MVM D</p> <p>MVM 3,0</p> <p>D = Ø3,0</p>	<p>Závitník</p> <p>Označenie: ZMV D</p> <p>ZMV 3,0</p>	<p>Trepanačný vrták</p> <p>Označenie: VM D</p> <p>VM 3,0 N 314</p>	<p>Zavádzací nástroj do rače</p> <p>Označenie: N 223 R D(K)</p> <p>N 223 RD Dlhý N 223 RK Krátky</p>	<p>Rača</p> <p>Označenie: N 523</p>
---	--	---	---	---	---	---	--

Postup zavádzania dentálnych implantátov

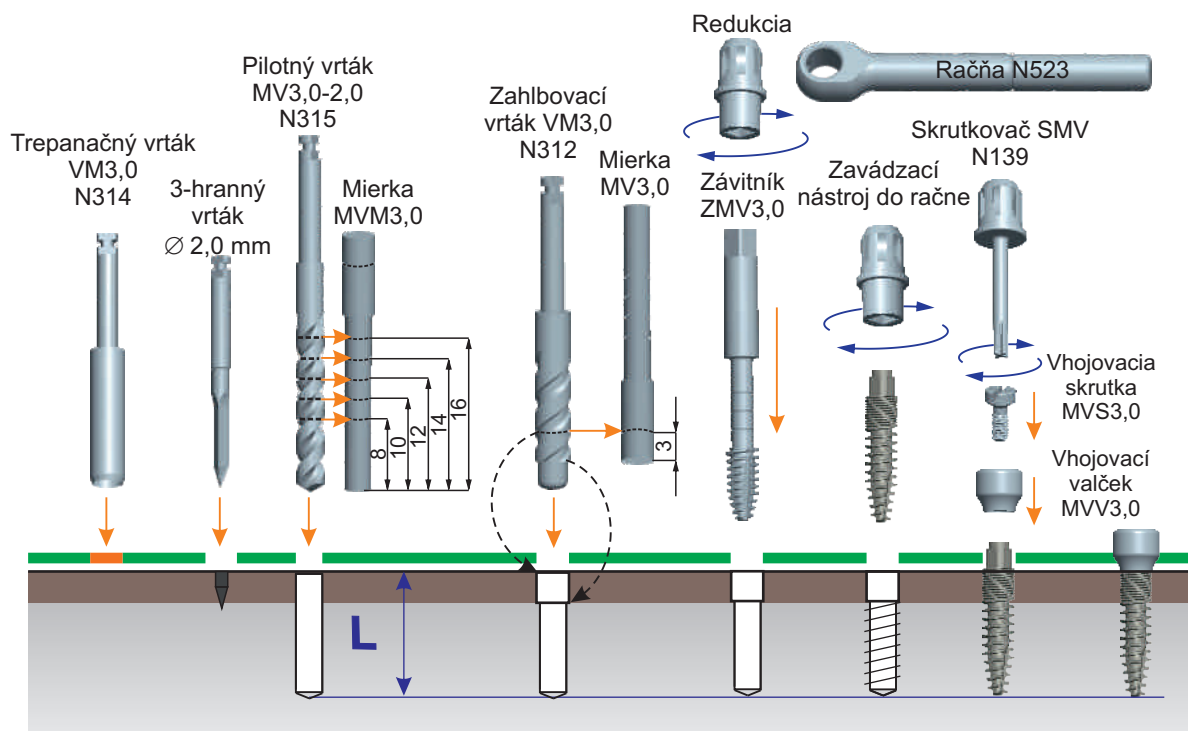

Protetický postup

